
Стоматологическая поликлиника в фокусе эпидемиолога

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕЛКИН

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ГАУЗ СО «СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»,
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

После страшной боли и ощущения чего-то огромного, больше самой головы, вытягиваемого из челюсти, больной вдруг, не веря еще своему счастию, чувствует, что не существует более того, что так долго отравляло его жизнь, приковывало к себе всё внимание, и что он опять может жить, думать и интересоваться не одним своим зубом.

Толстой Л. Н., Анна Каренина, 1877

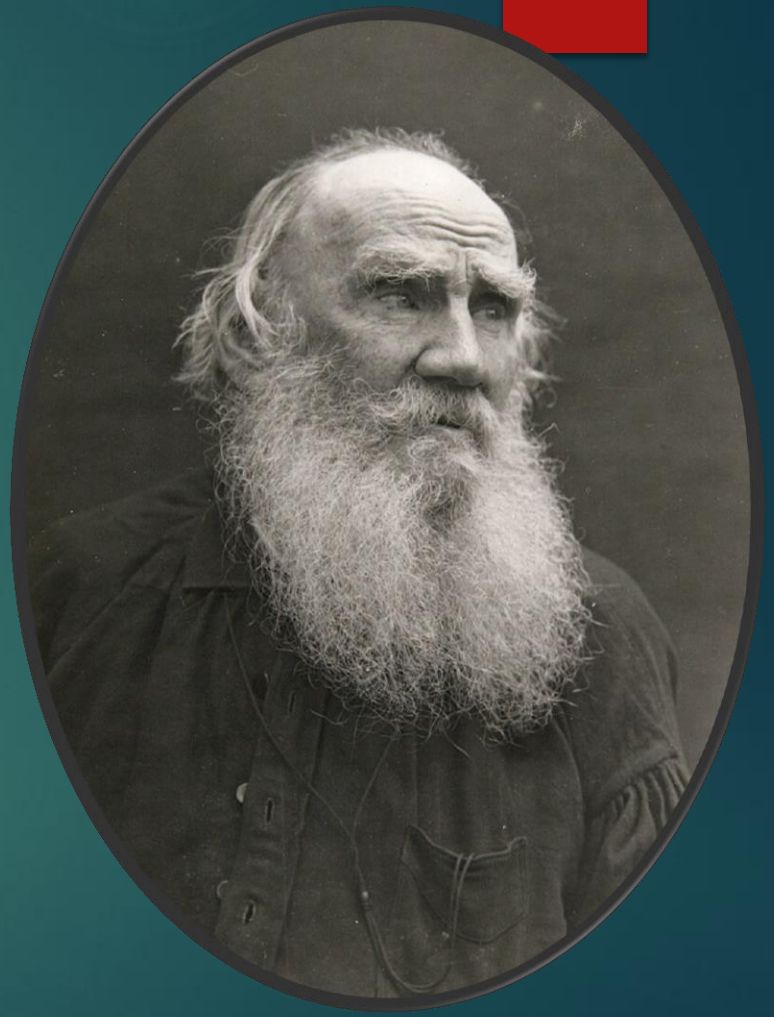

От ремесла к науке

Первые попытки лечения зубов люди предпринимали на самой заре развития цивилизации. Целителями были жрецы и шаманы, которые пытались победить зубную боль при помощи ритуалов и заклинаний. Это было не особенно эффективно, и чаще всего больной зуб потом попросту удаляли.




На территории современного Пакистана были найдены останки людей с ровными отверстиями явно искусственного происхождения в зубах. Этим захоронениям около 9 тысяч лет. Предполагается, что древние врачеватели использовали в качестве пломбировочного материала субстанцию, похожую на асфальт.



В Древнем Египте, как можно судить по найденным мумиям, врачи уже умели проводить довольно сложные операции, сверлить челюсть и прикреплять выпавшие или искусственные зубы при помощи золотой проволоки.
До наших дней дошло имя самого древнего из известных историкам стоматологов. Его звали Хеси-Ре, и на иероглифической табличке о нем написано: «Величайший из врачей, который лечит зубы».



Ученые Древней Греции, в том числе и знаменитый Гиппократ, воспаленный нерв выжигали раскаленным железом. Некоторые предложенные ими идеи и методы (например, шинирование при переломе или вывихе челюсти) в улучшенном виде используются и в наши дни.

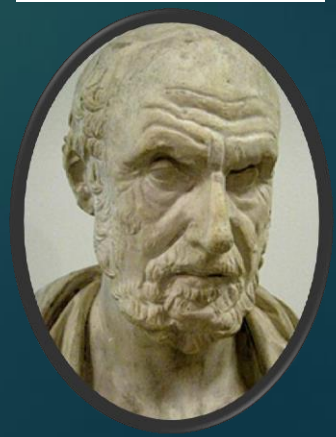

Новую страницу в истории зубоврачевания отрыл в I веке до н. э. римский врач Архиген, который впервые с лечебной целью вскрыл пульповую камеру зуба сверлом.
Тогда же римский медик Клавдий Гален описаны различия между пульпитом и периодонтитом.




Во времена Средневековья медицина полностью находилась под надзором церкви, которая признала хирургические операции, в том числе – удаление и лечение зубов, занятием, недостойным образованного врача. Зубоврачебная практика оказалась в руках цирюльников, банщиков, ремесленников и даже палачей



Пьер Фошар - основоположник современной стоматологии. Он лечил зубы Людовику XV, Дидро, кардиналу де Флери. Его монументальный труд «Дантист-хирург или Трактат о зубах», который был опубликован в 1728 году, стал настоящим прорывом. В нем были описаны около 130 стоматологических заболеваний, и впервые была предложена стройная система, объединившая все разделы зубоврачевания.
Стал первым врачом во Франции, который получил звание хирурга-дантиста, и вскоре огромный спрос на стоматологические услуги привел его к мысли о создании зубопротезного цеха. Он набирал работников из числа ювелиров средней руки и давал необходимые медицинские знания, после чего они сдавали экзамен и осваивали секреты протезирования. Так было положено начало специального образования для зубных техников.



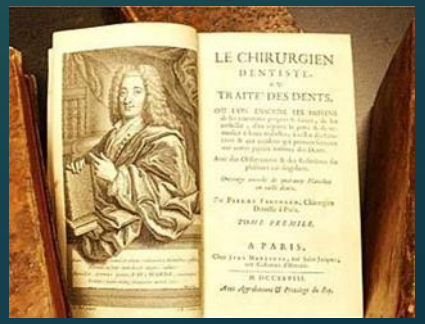

В 1684 году хирург Корнелиус Золинген использовал ручной бор для препарирования кариозных полостей.



В 1728 году Пьер Фошар опубликовал монументальный труд «Дантист-хирург или Трактат о зубах»



В 1847 Зе́ммельвейс описал значение мытья рук и промывки ногтей перед приёмом родов.



В 1864 году Джордж Харрингтон изобрел первую бормашину с мотором, которая заводилась ключом, подобно часам.




В 1867 Ли́стер разработал метод дезинфекции инструментов и ран 2–3 % раствором фенола (карболовая кислота).




В 1871 году дантист Джеймс Моррисон сконструировал первую бормашину с ножным приводом.




1877г. – выпущено в продажу кресло Вилкерсона первое кресло с гидравлическим механизмом.

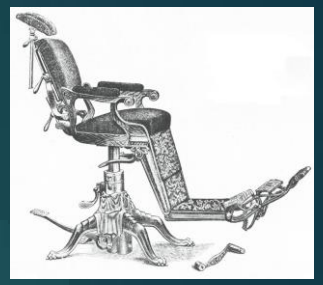

В 1890 Бергман (1836–1907) установил принципы асептики, согласно которым к операции всё уже должно находиться в стерильном виде.




В 1895 Рентгеном было открыто рентгеновское излучение.





В 1905 г. хирург Генрих Браун ввел новокаин в медицину.









Стратегическая задача здравоохранения – обеспечить качество медицинской помощи и создание безопасной среды пребывания для пациентов и персонала медицинских организаций

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»


3544. Дезинфекции подлежат объекты, которые могут служить факторами передачи ИСМП: медицинские изделия (включая медицинское оборудование), руки персонала, кожные покровы (операционное и инъекционное поле) пациентов, кожа локтевых сгибов доноров, предметы ухода за больными, воздух в помещениях класса чистоты А, Б и В, постельные принадлежности, посуда, рабочие поверхности медицинских столов, стоек, тележек, каталок, мебель, приборы, аппараты, больничный текстиль, уборочный инвентарь, медицинские отходы.

3548. Необходимо иметь отдельные емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств, используемых для обработки различных объектов:

отдельно для каждого этапа обработки медицинских изделий (ПСО, дезинфекция, дезинфекция +ПСО, ДВУ и т.д.));

для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования, санитарно-технического оборудования, предметов ухода за больными;

для обеззараживания уборочного материала, отходов классов Б и В.

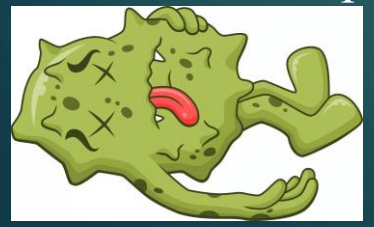



3579. Медицинские изделия многократного применения подлежат последовательно: дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, последующему хранению в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.



3586. Для предотвращения контаминации возбудителями ИСМП дезинфицирующих растворов их многократное использование для дезинфекции медицинских изделий допускается в течение рабочей смены, если их внешний вид не изменился (включая мутность, хлопья, осадок, изменение цвета) вне зависимости от наличия рекомендаций по срокам использования рабочих растворов дезинфицирующих средств, указанных в инструкциях по их применению.

3593. Предстерилизационную очистку изделий осуществляют ручным или механизированным способами путем мытья в растворе моющего средства после дезинфекции или при совмещении мытья с дезинфекцией в одном процессе (в зависимости от применяемого средства) в соответствии с инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к конкретному оборудованию.

3595. Раствор средства для предстерилизационной очистки (самостоятельной или совмещенной с дезинфекцией) при ручном способе очистки можно использовать многократно в течение одной рабочей смены, если это допускается инструкцией по применению средства. При механизированном способе очистки в моюще-дезинфицирующих машинах раствор используется однократно.



3549. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть снабжены плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи с указанием средства, его концентрации, назначения, даты приготовления.



3587. …изделия погружают в рабочий раствор средства с заполнением каналов и полостей. Разъемные изделия погружают в разобранном виде, инструменты с замковыми частями замачивают раскрытыми, сделав этими инструментами в растворе несколько рабочих движений.



3588. Объем емкости для проведения обработки и объем раствора средства в ней должны быть достаточными для обеспечения полного погружения медицинского изделия в раствор; толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее одного сантиметра.

4025. Дезинфекцию стоматологических оттисков, заготовок зубных протезов проводят после применения у пациентов перед направлением в зуботехническую лабораторию и после их получения из зуботехнической лаборатории непосредственно перед применением. Выбор дезинфицирующего средства обусловлен видом оттискного материала. После дезинфекции изделия промывают питьевой водой для удаления остатков дезинфицирующего средства.



ЖУРНАЛ

разведения дезинфекционных средств

[redacted]

перевязочный кабинет

Начат: «01» апреля 2025 г.

Окончен: «____» _____ 20___ г.


Дата разведения дез. средства	Наименование дез. средства	% концентрация дез. средства	Объём в литрах рабочего раствора	Экспозиция дез. средства	Срок годности рабочего раствора (дата окончания срока годности)	Объект обеззараживания	Роспись ответственного лица
21.05.25	Деза-Триз	0,5%	15 л	15'	03.07.25	инстр.лотки	
22.05.25	Деза-Триз	0,5%	15 л	15'	04.07.25	инстр. лотки	
23.05.25	Деза-Триз	0,5%	15 л	15'	05.07.25	инстр.лотки	
26.05.25	Деза-Триз	0,5%	15 л	15'	08.07.25	инстр лотки	
27.05.25	Деза-Триз	0,5%	15 л	15'	09.07.25	инстр лотки	
28.05.25	Деза-Триз	0,5%	15 л	15'	до 10.07.25	инстр лотк	


3597. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки проб (разрешенных к применению) на наличие остаточных количеств крови, а также путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств (только в случаях применения средств, рабочие растворы которых имеют pH более 8,5) в соответствии с инструкциями по применению конкретных средств.

3598. Контроль качества предстерилизационной очистки проводят ежедневно. Контролю подлежат: в ЦСО - 1% от каждого наименования изделий, обработанных за смену; при децентрализованной обработке - 1% одновременно обработанных изделий каждого наименования, но не менее трех единиц. Результаты контроля регистрируют в журнале.





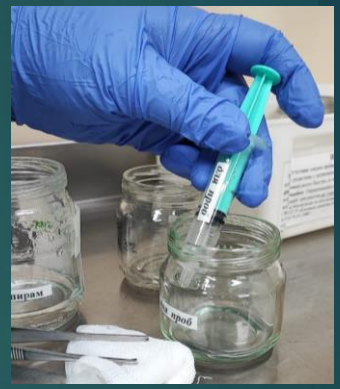

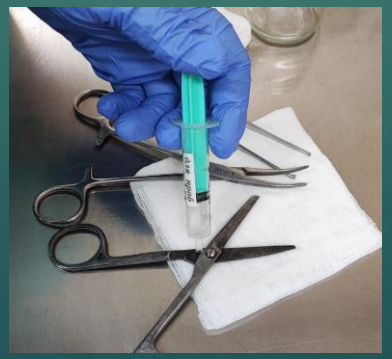


ЖУРНАЛ

учета качества предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения (ф. № 366/у)


в _____[redacted]_____

(наименование учреждения)


Начат: «3» 02 2025 г.

Окончен: «___»_____ 20__ г.



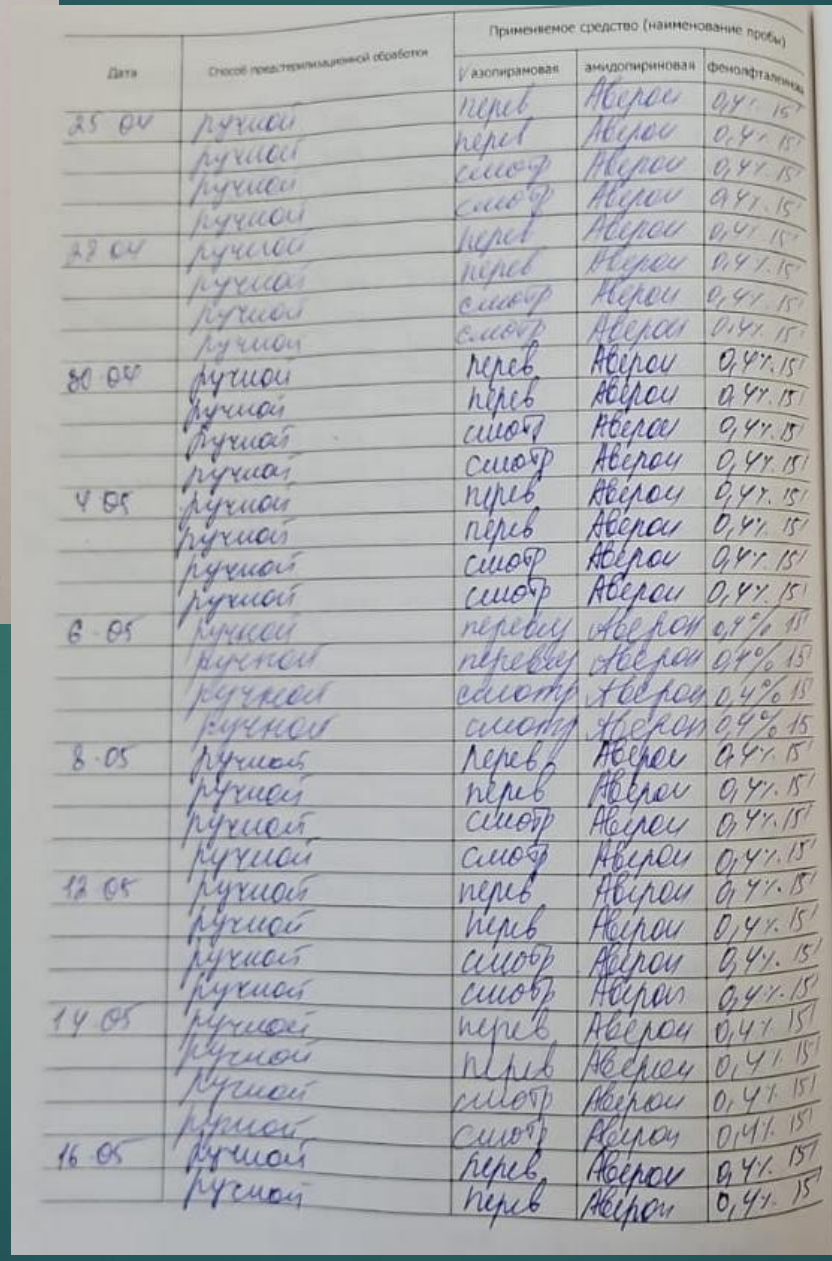

Дата	Способ предстерилизационной обработки	Применяемое средство (наименование пробы)		
		азопирамовая	амидопириновая	фенолфталиновая
25.04	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
27.04	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
30.04	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
4.05	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
6.05	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
8.05	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
12.05	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
14.05	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
	ручной	смотр	Аверон	0,4% 15'
16.05	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'
	ручной	перв	Аверон	0,4% 15'

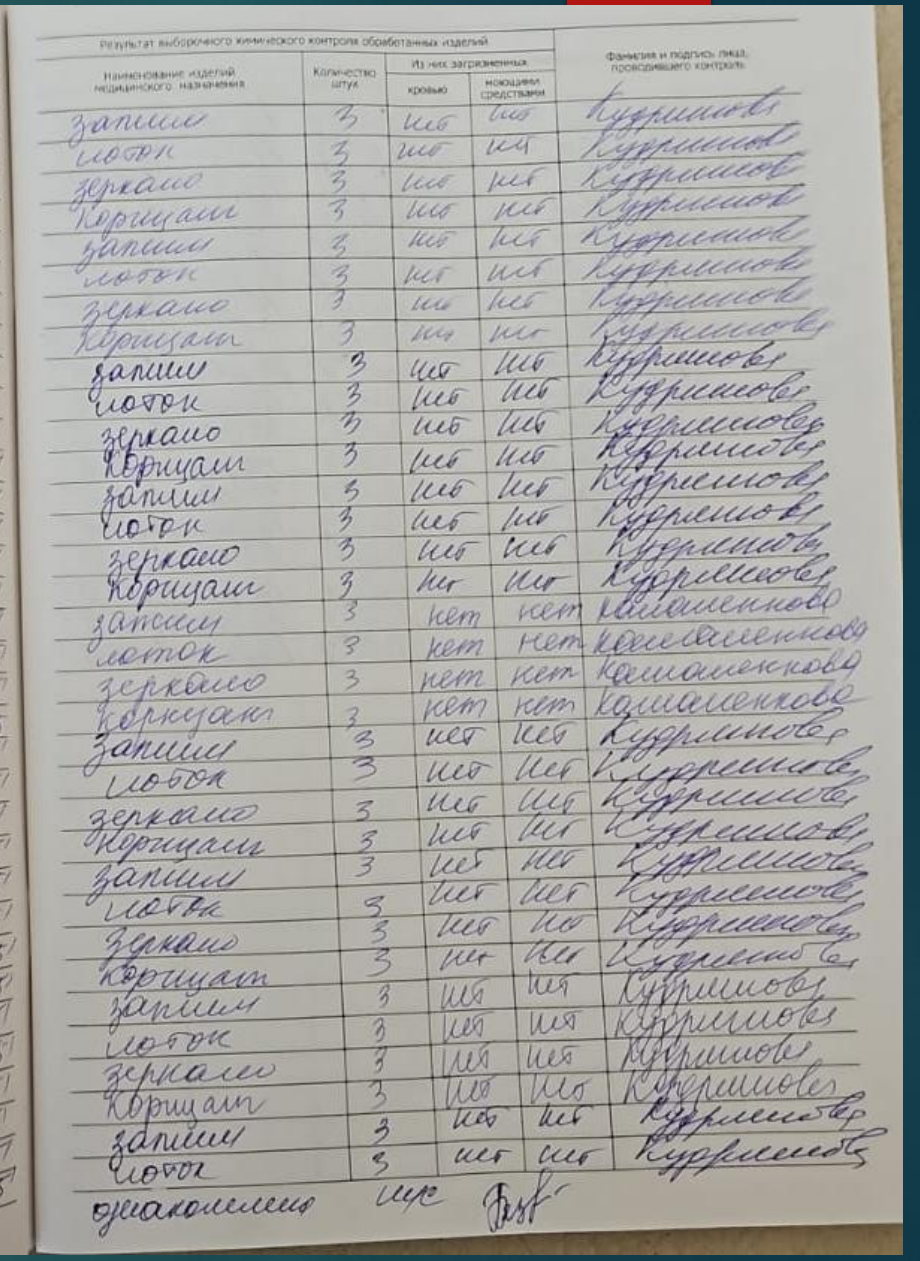

Наименование изделий медицинского назначения	Количество штук	Из них загрязненных		Фамилия и подпись лица, проводившего контроль
		кровью	моющими средствами	
зажим	3	нет	нет	Курмишова
пинцет	3	нет	нет	Курмишова
зеркало	3	нет	нет	Курмишова
Корнцанг	3	нет	нет	Курмишова
зажим	3	нет	нет	Курмишова
пинцет	3	нет	нет	Курмишова
зеркало	3	нет	нет	Курмишова
Корнцанг	3	нет	нет	Курмишова
зажим	3	нет	нет	Курмишова
пинцет	3	нет	нет	Курмишова
зеркало	3	нет	нет	Курмишова
Корнцанг	3	нет	нет	Курмишова
зажим	3	нет	нет	Курмишова
пинцет	3	нет	нет	Курмишова
зеркало	3	нет	нет	Курмишова
Корнцанг	3	нет	нет	Курмишова
зажим	3	нет	нет	Каманенкова
пинцет	3	нет	нет	Каманенкова
зеркало	3	нет	нет	Каманенкова
Корнцанг	3	нет	нет	Каманенкова
зажим	3	нет	нет	Курмишова
пинцет	3	нет	нет	Курмишова
зеркало	3	нет	нет	Курмишова
Корнцанг	3	нет	нет	Курмишова
зажим	3	нет	нет	Курмишова
пинцет	3	нет	нет	Курмишова
зеркало	3	нет	нет	Курмишова
корнцанг	3	нет	нет	Курмишова
зажим	3	нет	нет	Курмишова
пинцет	3	нет	нет	Курмишова
зеркало	3	нет	нет	Курмишова
Корнцанг	3	нет	нет	Курмишова
зажим	3	нет	нет	Курмишова
пинцет	3	нет	нет	Курмишова
ознакомлена	мед			

3599. Стерилизации подвергают все медицинские изделия многократного применения, контактирующие с раневой поверхностью, кровью (в организме пациента или вводимых в него) и (или) инъекционными препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой пациента, и могут вызвать ее повреждение.

Стерилизация

Пар | **Воздух** | **Инфракрасный** | **Химический** | **Гласперлен**

Упакованный

- Сроки хранения указываются на упаковке и определяются видом упаковочного материала согласно инструкции по его применению
- Использовать в течении 6 часов после вскрытия

Неупакованный

- Запрещается переносить из кабинета в кабинет
- Допускается хранить в разрешенных к применению бактерицидных (оснащенных ультрафиолетовыми лампами) камерах в течение срока, указанного в руководстве по эксплуатации оборудования, а в случае отсутствия таких камер - на стерильном столе не более 6 часов
- Не допускается хранение простерилизованных изделий в воздушном стерилизаторе и их использование на следующий день после стерилизации



ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

стерилизатор паровой МСОМ

Код формы по ОКУД:
Код учреждения по ОКПО:

начат: "24" 02 2025
окончен: "____" _____ 20__

[redacted]


Медицинская документация. Форма №257/у

Дата	Марка, № стерилизатора	Стерилизуемые изделия: наименование	Стерилизуемые изделия: кол-во	Упаковка	Время стерилизации, мин.: начало	Время стерилизации, мин.: конец	Режим: давление	Режим: температура	Тест-контроль: биологический	Тест-контроль: термический	Тест-контроль: химический	Подпись
20.02.25	Шкаф	набор дон. инстр	4 1/91	бел ун	9 00	9 45						
20.02.25	Шкаф	набор дон. инстр	4 1/91	бел ун	11 00	11 45						
26.02.25	Шкаф	набор дон. инстр	4 1/91	бел ун	8 00	8 45						
26.02.25	Шкаф	набор дон. инстр	4 1/91	бел ун	11 00	11 45						
		набор	4	бел								

3618. При необходимости, инструменты, простерилизованные в неупакованном виде одним из термических методов, после окончания стерилизации допускается хранить в разрешенных к применению бактерицидных камерах, оснащенных ультрафиолетовыми бактерицидными лампами в течение срока, указанного в руководстве по эксплуатации оборудования, а в случае отсутствия таких камер - на стерильном столе не более 6 часов.

3620. Бактерицидные камеры, оснащенные ультрафиолетовыми лампами, допускается применять только с целью хранения инструментов для снижения риска их вторичной контаминации микроорганизмами в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Запрещается применять такое оборудование с целью дезинфекции или стерилизации изделий, а также использовать медицинскую мебель со встроенными ультрафиолетовыми лампами.

125.46 все манипуляции по накрытию стерильного стола проводят в стерильном халате, маске и перчатках с использованием стерильных простыней. Делают отметку о дате и времени накрытия стерильного стола. Стерильный стол накрывают на 6 часов. Не использованные в течение этого срока материалы и инструменты со стерильного стола направляют на повторную стерилизацию;

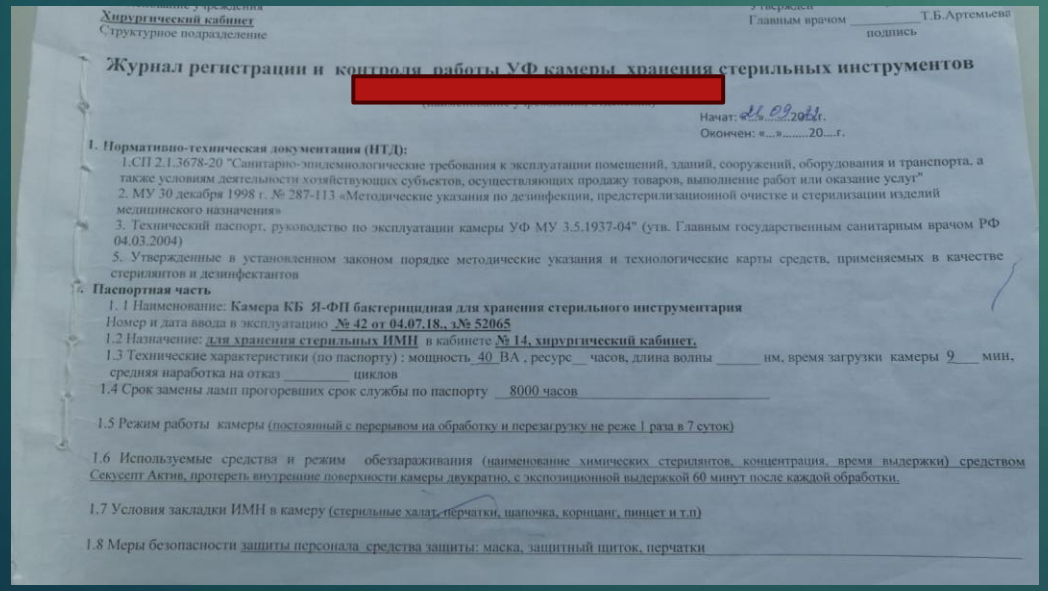

Хирургический кабинет
Структурное подразделение

Главным врачом _____Т.Б.Артемьева
подпись

Журнал регистрации и контроля работы УФ камеры хранения стерильных инструментов


[redacted]

Начат: «11» 09 2021г.
Окончен: «...»..... 20....г.

1. Нормативно-техническая документация (НТД):
1.СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
2. МУ 30 декабря 1998 г. № 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»
3. Технический паспорт, руководство по эксплуатации камеры УФ МУ 3.5.1937-04" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004)
5. Утвержденные в установленном законом порядке методические указания и технологические карты средств, применяемых в качестве стерилянтов и дезинфектантов

2. Паспортная часть
1. 1 Наименование: **Камера КБ Я-ФП бактерицидная для хранения стерильного инструментария**
Номер и дата ввода в эксплуатацию **№ 42 от 04.07.18., з.№ 52065**
1.2 Назначение: **для хранения стерильных ИМН** в кабинете **№ 14, хирургический кабинет.**
1.3 Технические характеристики (по паспорту) : мощность 40 ВА , ресурс __ часов, длина волны _____ нм, время загрузки камеры 9___ мин, средняя наработка на отказ _____ циклов
1.4 Срок замены ламп прогоревших срок службы по паспорту 8000 часов
1.5 Режим работы камеры (постоянный с перерывом на обработку и перезагрузку не реже 1 раза в 7 суток)
1.6 Используемые средства и режим обеззараживания (наименование химических стерилянтов, концентрация, время выдержки) средством Секусепт Актив, протереть внутренние поверхности камеры двукратно, с экспозиционной выдержкой 60 минут после каждой обработки.
1.7 Условия закладки ИМН в камеру (стерильные халат, перчатки, шапочка, корнцанг, пинцет и т.п)
1.8 Меры безопасности защиты персонала средства защиты: маска, защитный щиток, перчатки



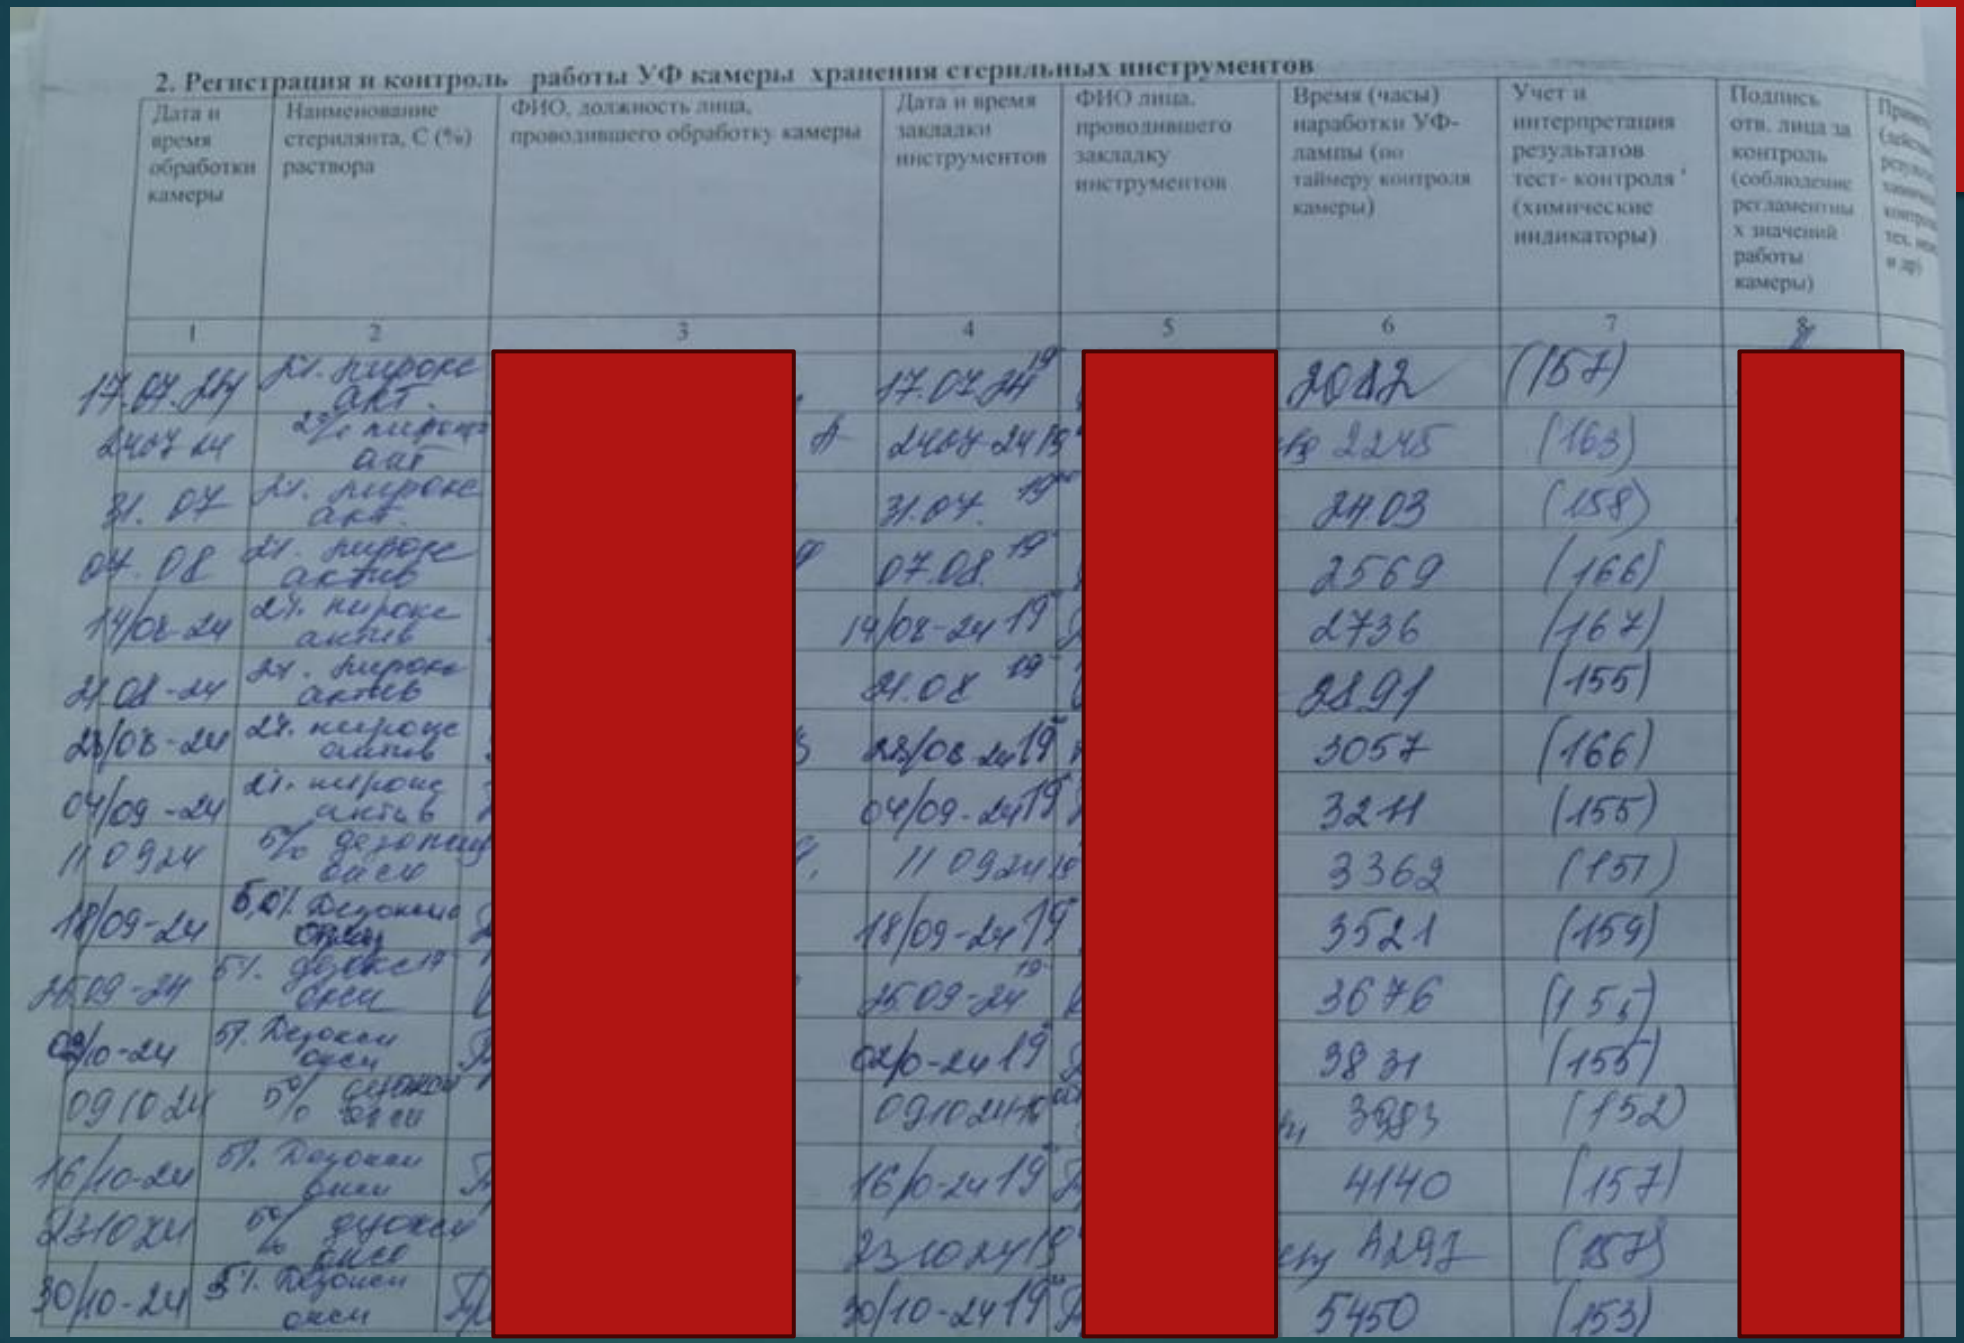


2. Регистрация и контроль работы УФ камеры хранения стерильных инструментов


Дата и время обработки камеры	Наименование стерилянта, С (%) раствора	ФИО, должность лица, проводившего обработку камеры	Дата и время закладки инструментов	ФИО лица, проводившего закладку инструментов	Время (часы) наработки УФ-лампы (по таймеру контроля камеры)	Учет и интерпретация результатов тест- контроля (химические индикаторы)	Подпись отв. лица за контроль (соблюдение регламентных значений работы камеры)	Примечание (замена, результаты химического контроля тест, инд. и др)
1	2	3	4	5	6	7	8	
17.07.24	21. хирург. акт.	[redacted]	17.07.24 19	[redacted]	2012	(157)	[redacted]	
24.07.24	21% хирург. акт		24.07.24 19		2245	(163)		
31.07	21. хирург. акт.		31.07. 19		2403	(158)		
07.08	21. хирург. актив		07.08. 19		2569	(166)		
14/08-24	21. хирург. актив		14/08-24 19		2736	(167)		
21.08-24	21. хирург. актив		21.08 19		2891	(155)		
28/08-24	21. хирург. актив		28/08-24 19		3057	(166)		
04/09-24	21. хирург. актив		04/09-24 19		3211	(155)		
11.09.24	6% дезоним акем		11.09.24 19		3362	(151)		
18/09-24	6,0% дезоним акем		18/09-24 19		3521	(159)		
25.09-24	6%. дезоним акем		25.09-24 19		3676	(155)		
02/10-24	6%. дезоним акем		02/10-24 19		3831	(155)		
09.10.24	6% дезоним акем		09.10.24 19		3983	(152)		
16/10-24	6%. дезоним акем		16/10-24 19		4140	(157)		
23.10.24	6% дезоним акем		23.10.24 19		4297	(157)		
30/10-24	6%. дезоним акем		30/10-24 19		5450	(153)		





Материал

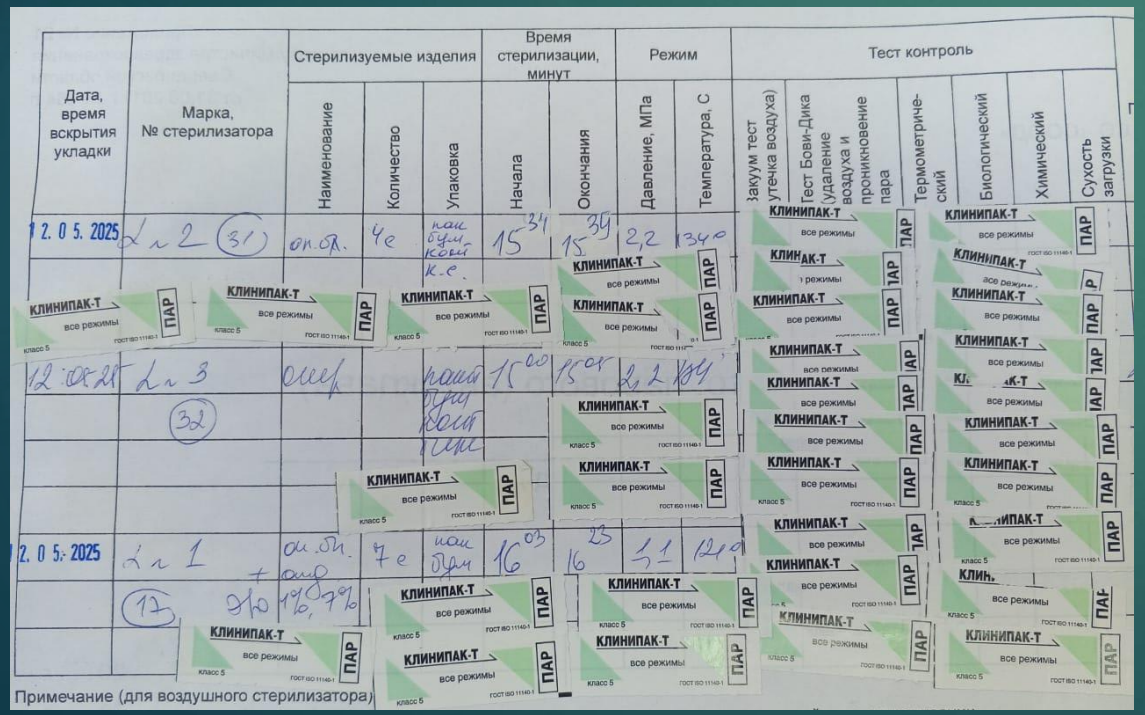


Дата, время вскрытия укладки
Марка, № стерилизатора
Стерилизуемые изделия
Наименование
Количество
Упаковка
Время стерилизации, минут
Начала
Окончания
Режим
Давление, МПа
Температура, С
Тест контроль
Вакуум тест (утечка воздуха)
Тест Бови-Дика (удаление воздуха и проникновение пара)
Термометрический
Биологический
Химический
Сухость загрузки
12.05.2025
КЛИНИПАК-Т
все режимы
ПАР
Примечание (для воздушного стерилизатора)

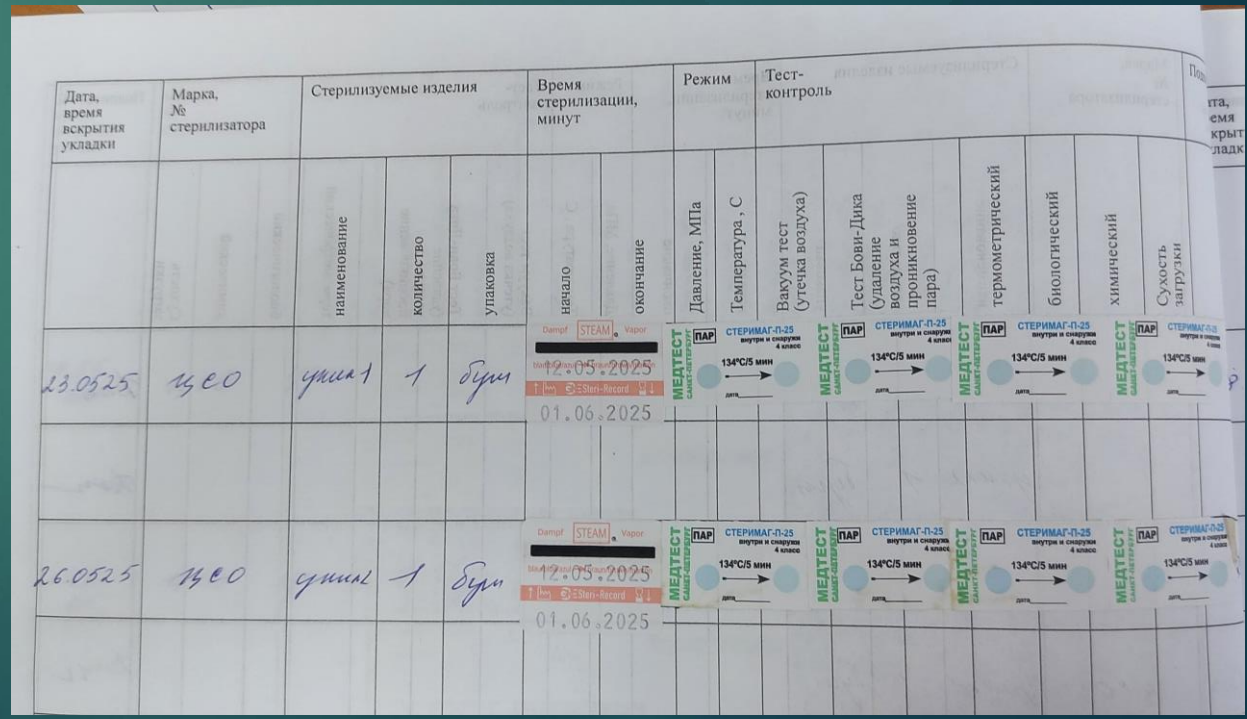
Дата, время вскрытия укладки
Марка, № стерилизатора
Стерилизуемые изделия
наименование
количество
упаковка
Время стерилизации, минут
начало
окончание
Режим
Давление, МПа
Температура, С
Тест-контроль
Вакуум тест (утечка воздуха)
Тест Бови-Дика (удаление воздуха и проникновение пара)
термометрический
биологический
химический
Сухость загрузки
23.0525
26.0525
12.05.2025
01.06.2025
МЕДТЕСТ
ПАР
134°С/5 мин

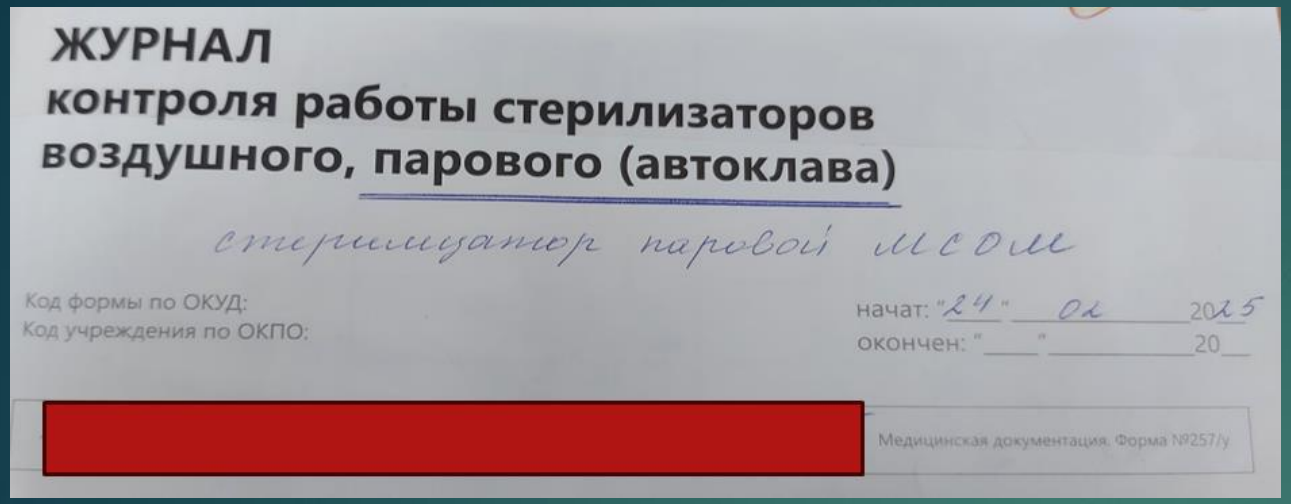

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)


стерилизатор паровой МСОМ

Код формы по ОКУД:
Код учреждения по ОКПО:


начат: "24" 02 2025
окончен: "____" _____20__

[redacted]

Медицинская документация. Форма №257/у

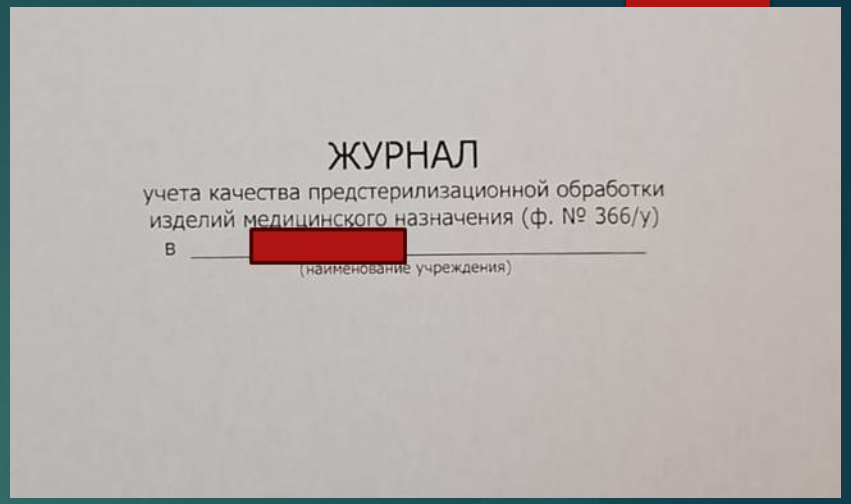

ЖУРНАЛ
учета качества предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения (ф. № 366/у)
в [redacted]
(наименование учреждения)

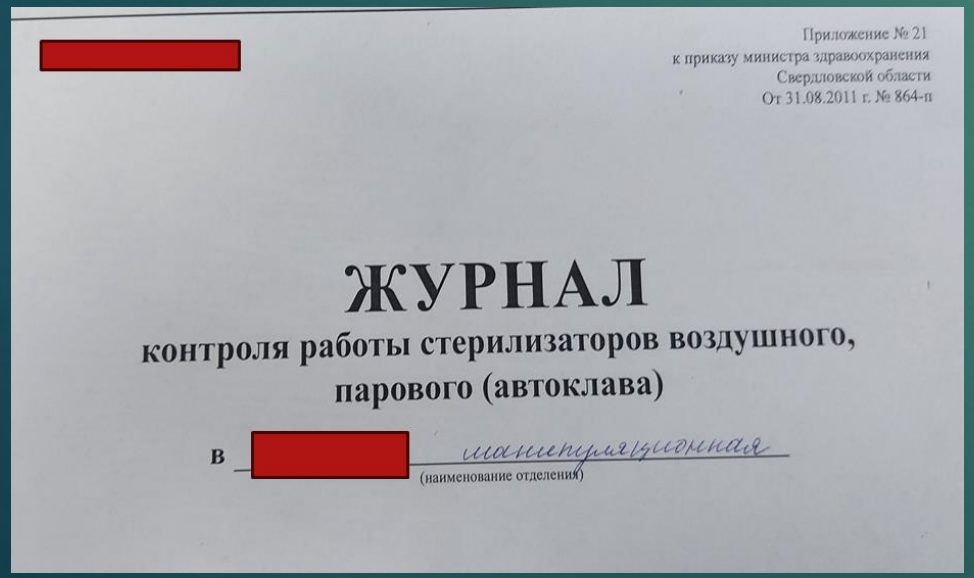


[redacted]

Приложение № 21
к приказу министра здравоохранения
Свердловской области
От 31.08.2011 г. № 864-п

ЖУРНАЛ
контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

в [redacted] манипуляционная
(наименование отделения)

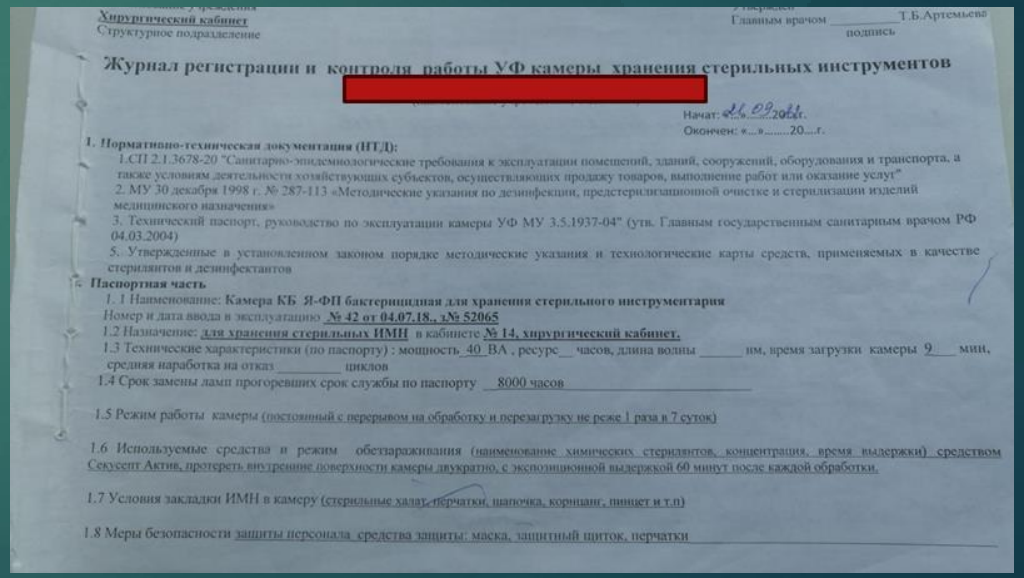

Хирургический кабинет
Структурное подразделение

Главным врачом _____Т.Б.Артемьева
подпись

Журнал регистрации и контроля работы УФ камеры хранения стерильных инструментов
[redacted]

Начат: «...» 09 2021г.
Окончен: «...»....20....г.

1. Нормативно-техническая документация (НТД):
1.СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
2. МУ 30 декабря 1998 г. № 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения»
3. Технический паспорт, руководство по эксплуатации камеры УФ МУ 3.5.1937-04" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004)
5. Утвержденные в установленном законом порядке методические указания и технологические карты средств, применяемых в качестве стерилянтов и дезинфектантов

Паспортная часть
1. 1 Наименование: Камера КБ Я-ФП бактерицидная для хранения стерильного инструментария
Номер и дата ввода в эксплуатацию № 42 от 04.07.18., № 52065
1.2 Назначение: для хранения стерильных ИМН в кабинете № 14, хирургический кабинет.
1.3 Технические характеристики (по паспорту) : мощность 40 ВА , ресурс__ часов, длина волны _____ нм, время загрузки камеры 9 мин, средняя наработка на отказ _____ циклов
1.4 Срок замены ламп прогоревших срок службы по паспорту 8000 часов
1.5 Режим работы камеры (постоянный с перерывом на обработку и перезагрузку не реже 1 раза в 7 суток)
1.6 Используемые средства и режим обеззараживания (наименование химических стерилянтов, концентрация, время выдержки) средством Секусепт Актив, протереть внутренние поверхности камеры двукратно, с экспозиционной выдержкой 60 минут после каждой обработки.
1.7 Условия закладки ИМН в камеру (стерильные халат, перчатки, шапочка, корнцанг, пинцет и т.п)
1.8 Меры безопасности защиты персонала средства защиты: маска, защитный щиток, перчатки

3431. С целью профилактики возникновения ИСМП и других нежелательных состояний (токсических, аллергических и других) запрещается:
повторное использование медицинских изделий однократного применения;
использование медицинских изделий и лекарственных средств с истекшим сроком годности, а также с нарушением условий хранений и транспортировки, указанным производителем;
повторная стерилизация медицинских изделий однократного применения с истекшим сроком годности.


3623. Не допускается использование медицинских изделий с истекшим сроком хранения после стерилизации.

3469. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в необходимом количестве и соответствующих размеров (перчатками, масками, очками, щитками, респираторами, фартуками, нарукавниками и другими) в зависимости от профиля отделения и характера проводимой работы.

ЖУРНАЛ

учета регистрации и контроля эксплуатации ультрафиолетовой бактерицидной установки

1 144 (с ософ)

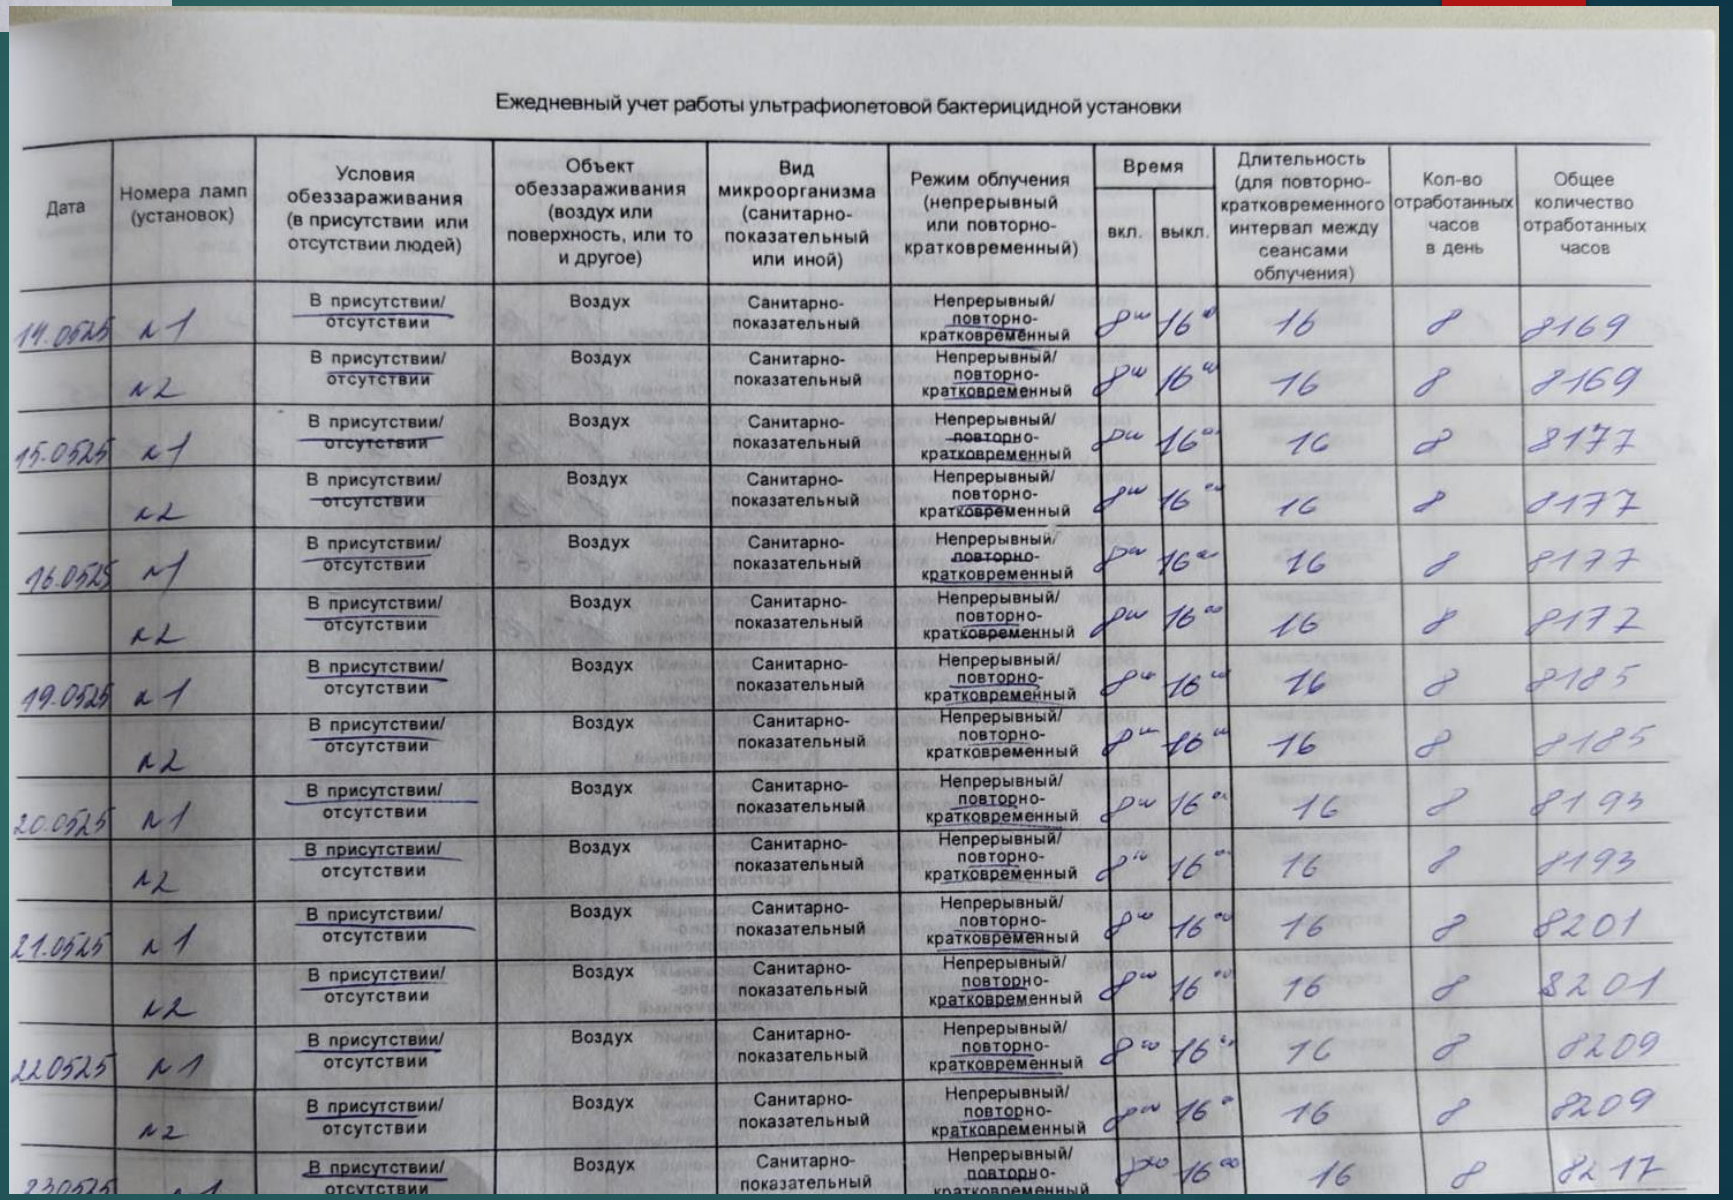

Ежедневный учет работы ультрафиолетовой бактерицидной установки

Дата	Номера ламп (установок)	Условия обеззараживания (в присутствии или отсутствии людей)	Объект обеззараживания (воздух или поверхность, или то и другое)	Вид микроорганизма (санитарно-показательный или иной)	Режим облучения (непрерывный или повторно-кратковременный)	Время		Длительность (для повторно-кратковременного интервал между сеансами облучения)	Кол-во отработанных часов в день	Общее количество отработанных часов
						вкл.	выкл.			
14.05.25	№1	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8169
	№2	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8169
15.05.25	№1	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8177
	№2	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8177
16.05.25	№1	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8177
	№2	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8177
19.05.25	№1	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8185
	№2	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8185
20.05.25	№1	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8193
	№2	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8193
21.05.25	№1	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8201
	№2	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8201
22.05.25	№1	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8209
	№2	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8209
23.05.25	№1	В присутствии/ отсутствии	Воздух	Санитарно-показательный	Непрерывный/ повторно-кратковременный	8ш	16ш	16	8	8217

ЖУРНАЛ

Учета проведения генеральных уборок



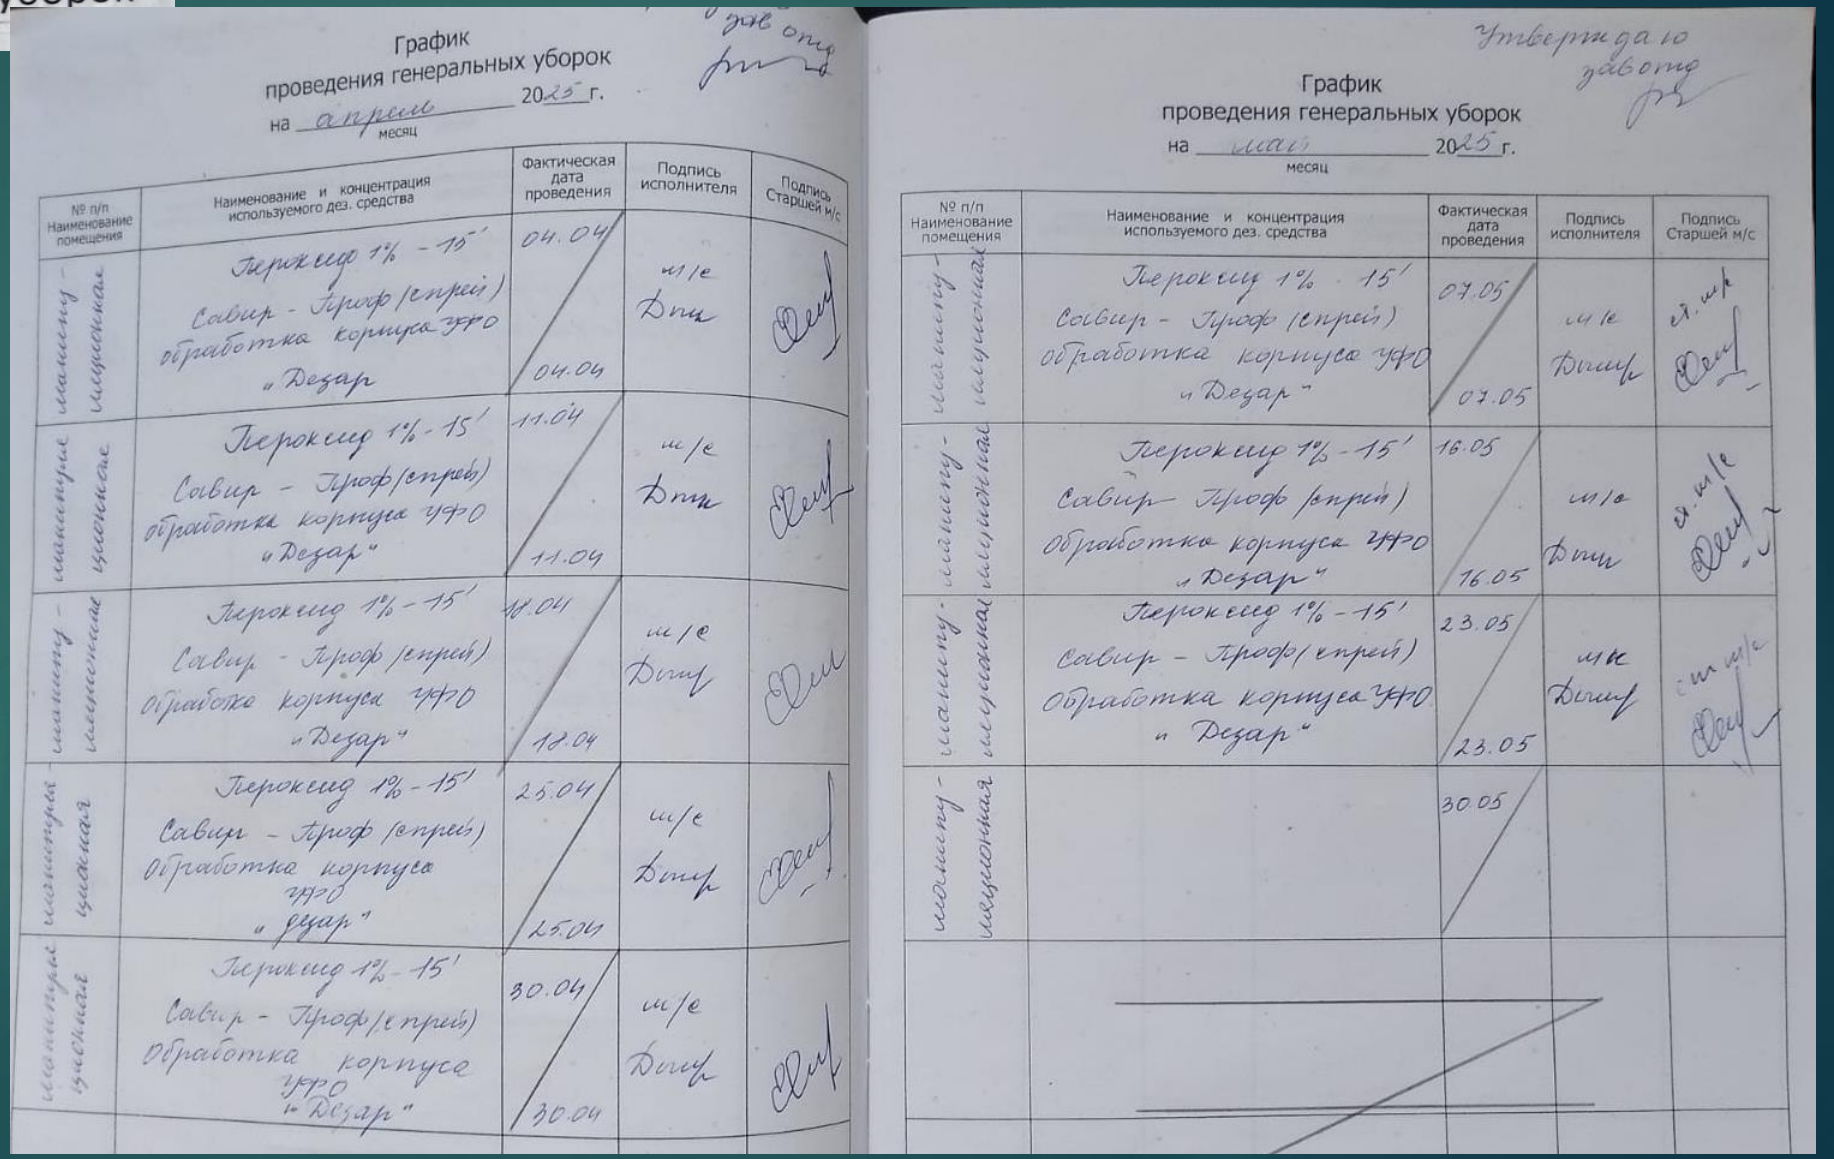


График
проведения генеральных уборок
на апрель месяц 2025 г.

№ п/п Наименование помещения	Наименование и концентрация используемого дез. средства	Фактическая дата проведения	Подпись исполнителя	Подпись Старшей м/с
	Пероксид 1% - 15' Савир - Профф (спрей) обработка корпуса УФО «Дезар»	04.04 / 04.04	м/с Дмт	
	Пероксид 1% - 15' Савир - Профф (спрей) обработка корпуса УФО «Дезар»	11.04 / 11.04	м/с Дмт	
	Пероксид 1% - 15' Савир - Профф (спрей) обработка корпуса УФО «Дезар»	12.04 / 12.04	м/с Дмт	
	Пероксид 1% - 15' Савир - Профф (спрей) обработка корпуса УФО «дезар»	25.04 / 25.04	м/с Дмт	
	Пероксид 1% - 15' Савир - Профф (спрей) обработка корпуса УФО «Дезар»	30.04 / 30.04	м/с Дмт	

Утверждаю
завхоз

График
проведения генеральных уборок
на май месяц 2025 г.

№ п/п Наименование помещения	Наименование и концентрация используемого дез. средства	Фактическая дата проведения	Подпись исполнителя	Подпись Старшей м/с
	Пероксид 1% - 15' Савир - Профф (спрей) обработка корпуса УФО «Дезар»	07.05 / 07.05	м/с Дмт	
	Пероксид 1% - 15' Савир - Профф (спрей) обработка корпуса УФО «Дезар»	16.05 / 16.05	м/с Дмт	
	Пероксид 1% - 15' Савир - Профф (спрей) обработка корпуса УФО «Дезар»	23.05 / 23.05	м/с Дмт	
		30.05		

Благодарю за внимание!

